

ブリスター形状変更のお知らせ

謹啓

平素は、格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.8mL」「ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.4mL」につきまして、各種製剤に対応できる共通ブリスター形状に変更致します。

「ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.8mL」につきましてはロット番号により新旧ブリスターが混在する状況が発生し、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。


2016年9月
謹白

「ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.8mL」ブリスター形状の変更点


現行品

新ブリスター形状

シリンジの固定箇所が4箇所から3箇所へ変更となります。

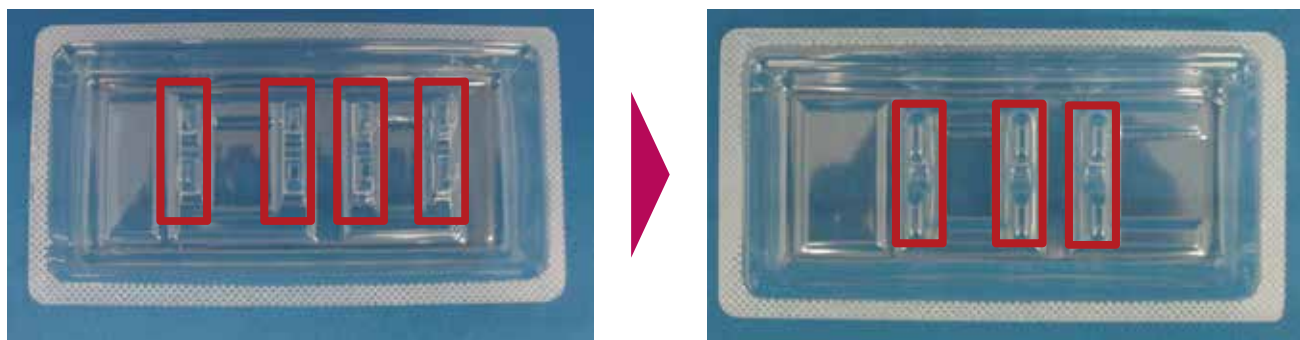

ブリスター内のシリンジ配置位置が左右非対称から左右対称になります。


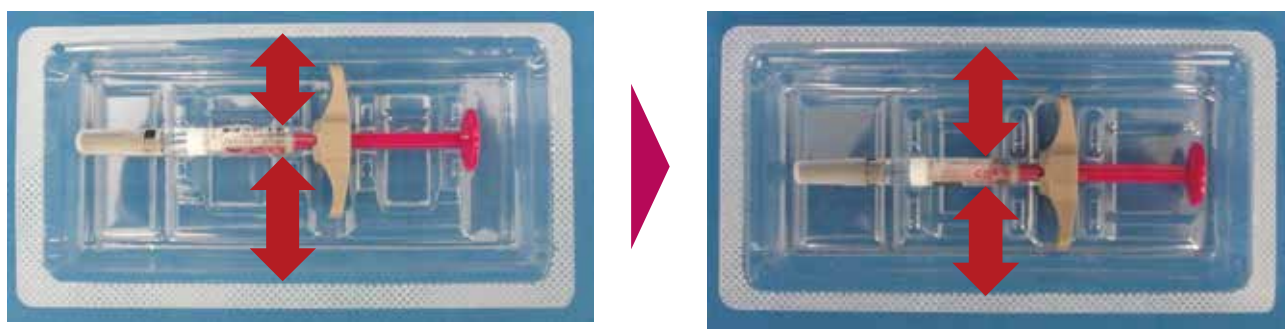


「ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.4mL」ブリスター形状の変更点

現行品

新ブリスター形状

ブリスター内のシリンジ配置位置が左右非対称から左右対称になります。

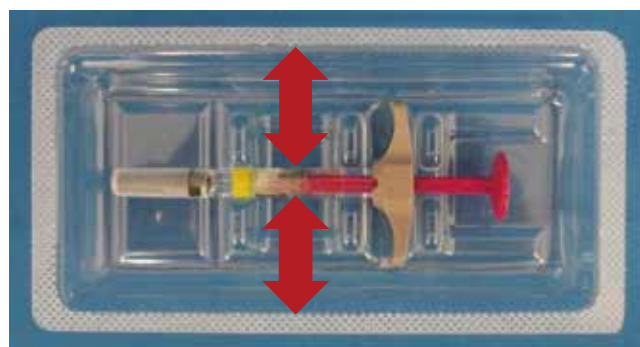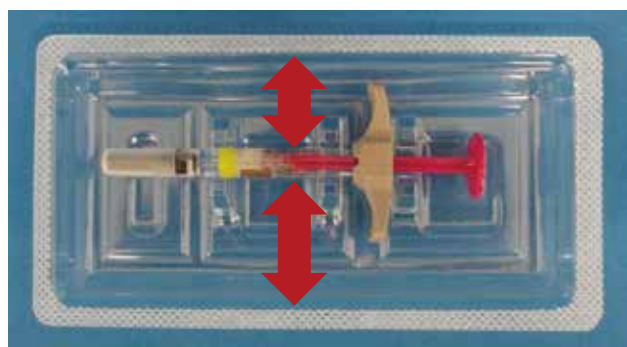

※なお「ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.4mL」に関してはシリンジ固定箇所は3箇所のみ変更ありません。

製品名	製造番号	ブリスタータイプ	出荷時期
ヒュミラ皮下注®20mgシリンジ0.4mL	62160XH02	現行品	出荷中
	62160XH04	新ブリスター形状	12月中旬
ヒュミラ皮下注®40mgシリンジ0.8mL	58117XH03	現行品	出荷中
	58117XH04	新ブリスター形状	10月上旬
	62160XH03	現行品	10月下旬
	66197XH01	新ブリスター形状	11月中旬